

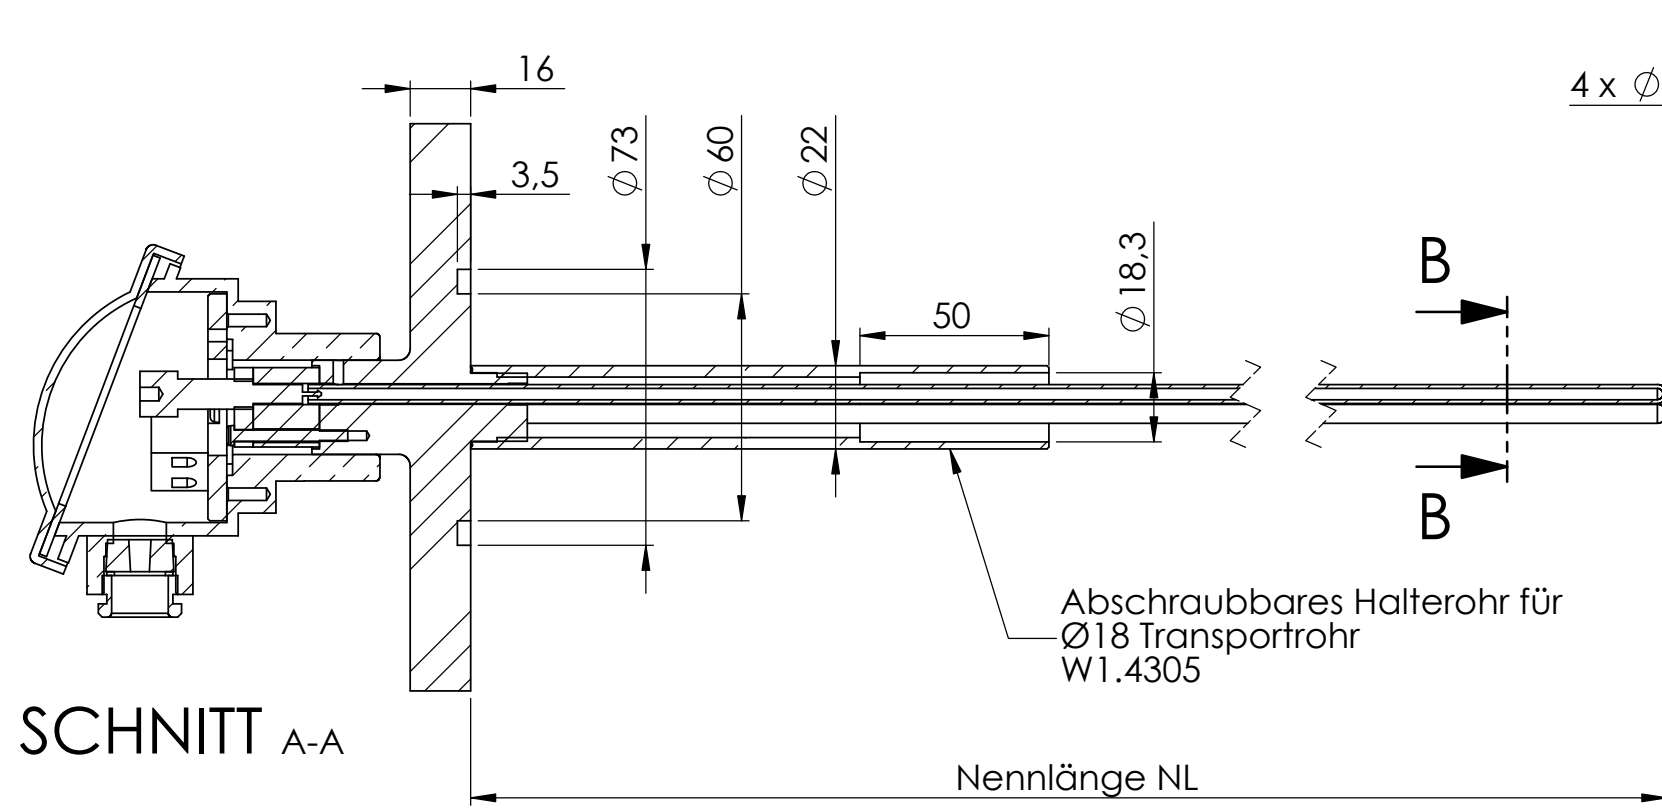



Die Vervielfältigung, Übertragung oder Gebrauch dieses Dokumentes, ist ohne explizite schriftliche Genehmigung nicht autorisiert. Zuwiderhandlungen sind haftbar für verursachte Schäden, alle Rechte, einschließlich erteilter Patente, eingetragene Markenzeichen oder Gebrauchsmuster, sind vorbehalten.

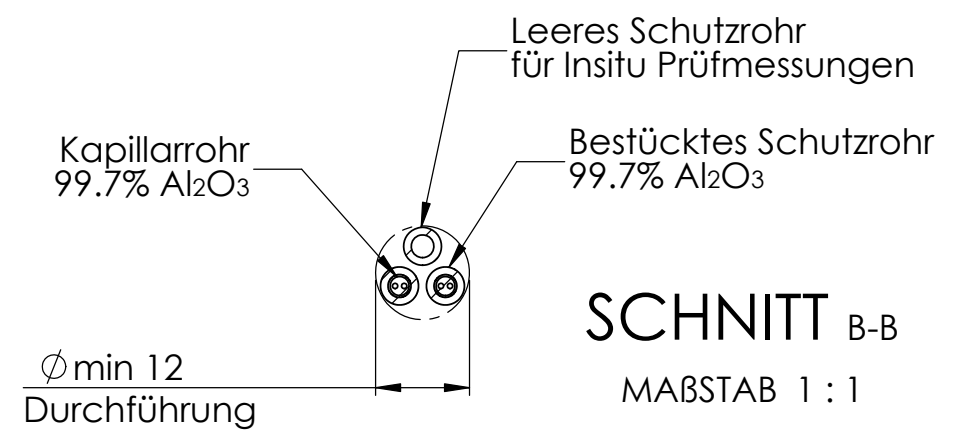

**SCHNITT A-A**

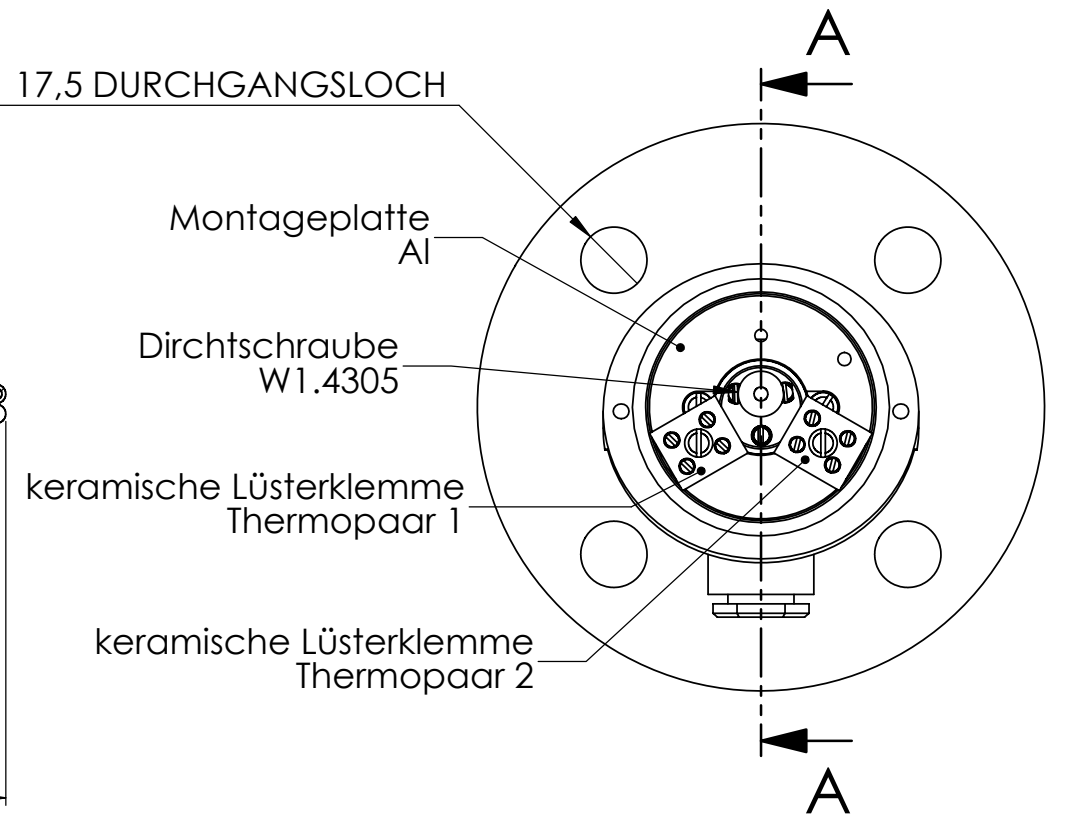

**SCHNITT B-B**  
MAßSTAB 1 : 1

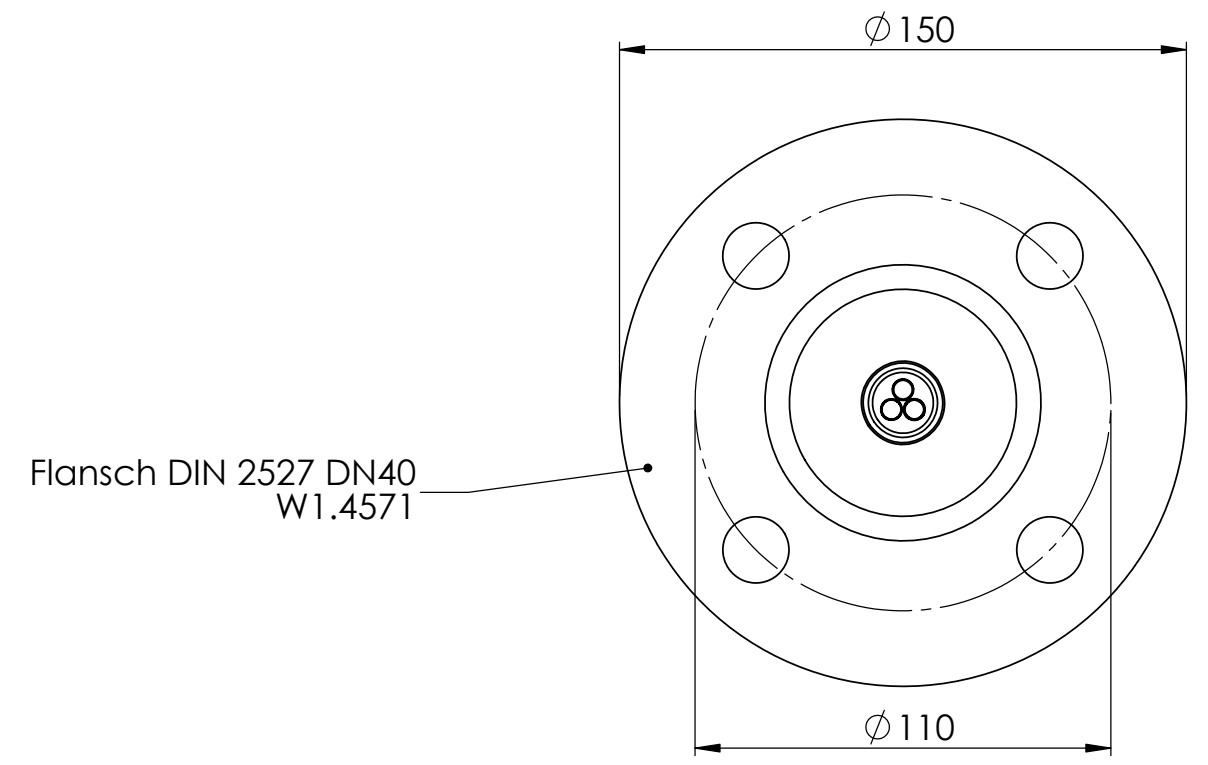

**Thermopaare:** Typ S DIN EN 60584-1, Klasse 1

**Kalibrierzertifikat**  
basierend auf Fixpunktmessung Gold und Palladium  
Korrekturwerte 500°C bis 1500°C in 100K Schritten  
andere Messpunkte auf Anfrage

Kalibrierung nach AMS 2750 auf Anfrage

DOKUMENT STATUS: <b>Public</b>		OBERFLÄCHENGÜTE: Toleranzen: ISO 2768-mK		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN -0.5	ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN	ÄNDERUNG 19.10.2023
				thermo-control Körtvélyessy GmbH		www.thermo-control.com Tel: +49(0)3040586940
				BENENNUNG: <b>Vakuum-Thermoelement</b>		
				ZEICHNUNGSNR. <b>13-2003-FLDN40</b>		A3
				MAßSTAB:1:2		BLATT 1 VON 1

The reproduction, transmitting or use of this document is not permitted without the express written authority. Offenders are liable for damages. All rights created by patent grant, registered trademarks or a utility model or design, are reserved.